

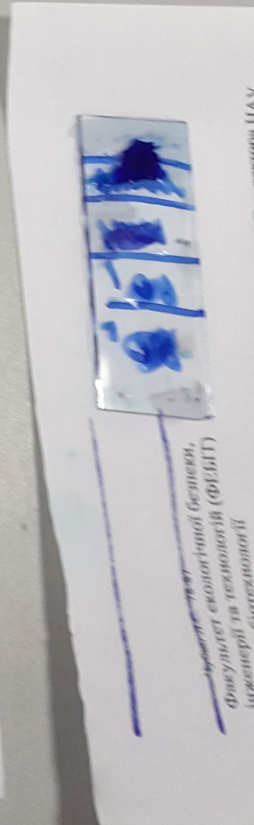


- | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 - окуляри | 5 - предметний столик | 9 - ручка тонкої фокусування |
| 2 - бінокулярна насадка | 6 - конденсатор | ручка грубої фокусування |
| 3 - револьверний пристрій | 7 - дзеркало | 10 - фокусування |
| 4 - об'єктив | 8 - ручка переміщення кроштейна конденсатора | 11 - тубусотримач |
| | | 12 - гвинт для прикріплення насадки |

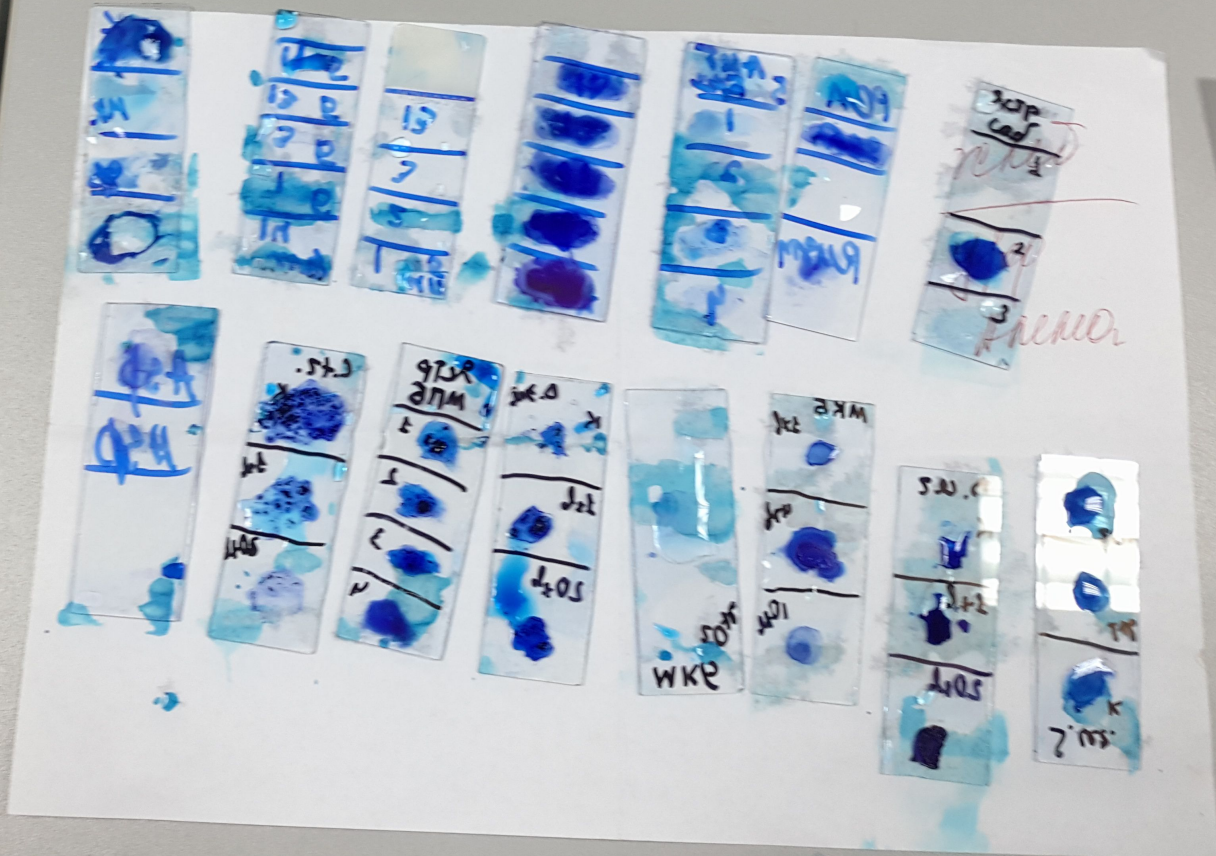

СВОЄ
МОЛОКО
ПІСЛЯ ПАСТЕРИЗАЦІЇ
У ПАРТИЦІЙНОМУ ПАКЕТІ

лакто
вит.с добавки

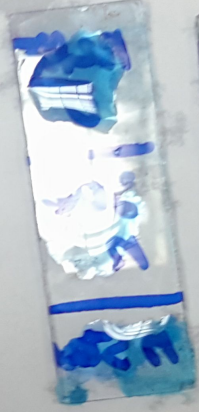

Додаток

НОТ

Салат


Для
навчального
матеріалу



Велика проба
стерильного п
матеріалу

LTMS 50

1660003 2

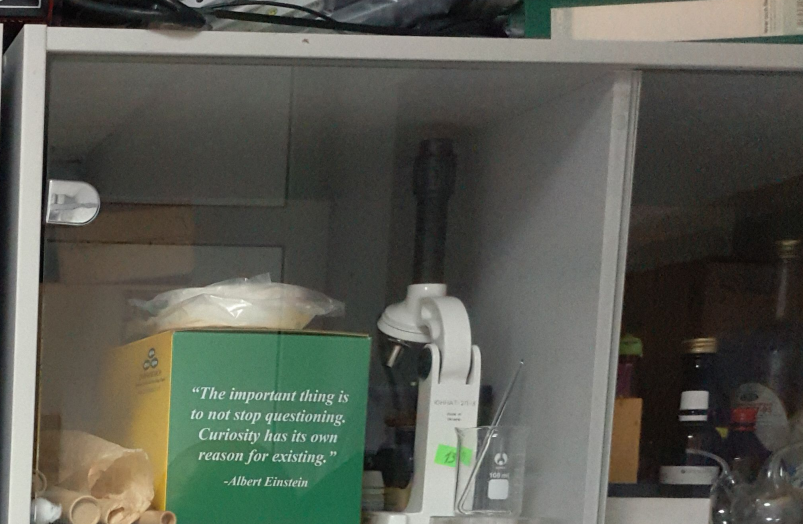

"The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."
-Albert Einstein



ETHS 50

*"The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."
-Albert Einstein*

TOMO
Ergonomics
SAFETY
COMFORT

5.614 Шафа 1,2

1.	Комплекс пробо підготовки	10490012ЯА
2.	Дозатор піпеточний ДВП-1	10490013ЯА
3.	Дозатор піпеточний ДВП-1	10490014ЯА
4.	Насос вакуумний Комовського	10490021ЯА
5.	Вимірювач температури газоповітряного потоку ИТ-	10490077ЯА
6.	Мікрометр окулярний МОВ- 1-16	10430051ЯА
7.	Управляючий блок АНК-32	10430091ЯА
8.	Денситометр ДЕН-1	10430095ЯА
9.	Вимірювач швидкості газоповітряного потоку ИС-2	10490076ЯА
10.	Програмована нагрівальна кришка - реального часу АНК- 32	10490081ЯА
11.	Центріфуга вортекс MSC-3000	10490087ЯА
12.	Портативний РН-метр Н18314	10490088ЯА
13.	Центріфуга MIM SPRIN	10490089ЯА
14.	Трансілюмінатор УВТ-1	10490090ЯА
15.	Камера для горизонтального гель-електрофорезу піддон 7*7, гребінка 2*8 зразків, комплектуючі для формування гелю.	101450001ЮФ
16.	Шейкер лабораторний універсальний ШО-10	101450050
17.	Дозатор для пипеток ДП-1-10	
18.	Вортекс для пробірок В-7	111370015ФР




Виробник "Моно стар" Україна
Дата виробу: 01.2018
Код: смач.біологічний
Матеріал: вугор. шкар.
Матеріал: поліпроп. шкар.
Матеріал: поліпроп. ТЕРП.
Чистота: адіоні
Арт. 136-7584-31
р 39
Підстава 1
Виробник ДСЗС: №08.03.02.041.17841 від 08.08.2018 р.

Субстрат для культивування мікроорганізмів
Склад: 100% вугор. шкар.
Масса нетто: 1000 г
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.

Субстрат для культивування мікроорганізмів
Склад: 100% вугор. шкар.
Масса нетто: 1000 г
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.

сахароза

Субстрат для культивування мікроорганізмів
Склад: 100% вугор. шкар.
Масса нетто: 1000 г
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: в сухом, прохладном месте, защищенном от света.

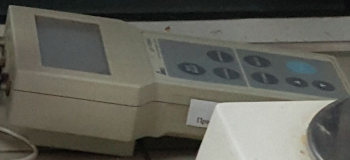

Квітка смаку Квітка смаку




НЕ ЧІПАТИ!

Дирлош.

Виробник "Моно стар" Україна
Дата виробу: 01.2018
Код: 00000000000000000000
Чиселно жителі
Арт. 136-7584-31
39
Повна С

Схароза
Схароза

Прод. фазована
уважати
своєю старт
на підставі

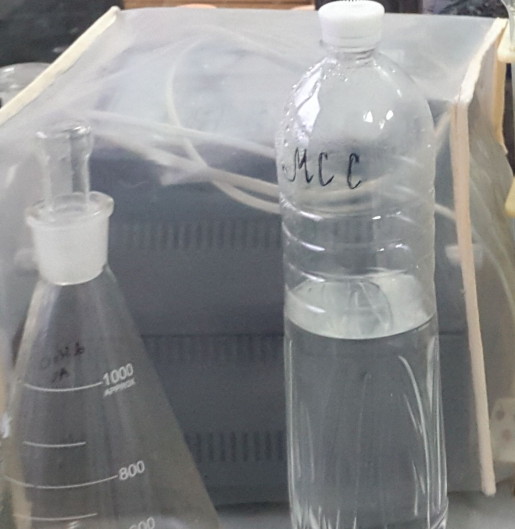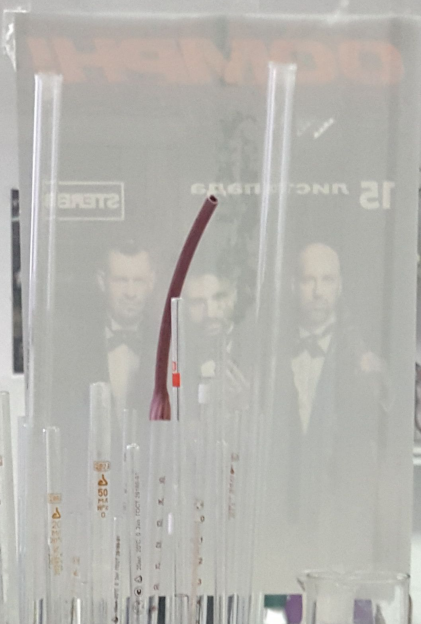

ТЕМПЕРАТУРА °C

888

ВЫДЕРЖКА min

888

ВЫБОР РЕЖИМА



ОТКЛ. ЗВУКА



РЕЖИМ



НАГРЕВ



СТЕРИЛИЗАТОР
ВОЗДУШНЫЙ

ГП-80

МИЗ

СЕТЬ



КОС ДЛЯ ПЕРЕНОСЕННЯ
БИОМАТЕРІАЛІВ



ТЕМПЕРАТУРА °C

888

ВЫДЕРЖКА min

888

ВЫБОР РЕЖИМА



ОТКЛ. ЗВУКА



РЕЖИМ

НАГРЕВ



СТЕРИЛИЗАТОР
воздушный


ГП-80

МИЗ

СЕТЬ



ПРЕСЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ





ФЕП 5.64

ФЕП 5.64

ФЕП 5.64

ФЕП 5.64

ФЕП 5.64

ВАС ДЛЯ ПЕРЕНОСЕННЯ
БИОМАТЕРІАЛІВ

ТЕМПЕРАТУРА °C

988

ВІДТРИМКА MIN

888

ВИБІР РЕЖИМА

ОТІЛ. ЖИВ.

РЕЖИМ

НАГРЕВ

СТЕРИЛІЗАТОР
МОДЕРНІЗОВАНО

ГП-30

СЕТЬ





Автоклав для стерилізації

2200001

















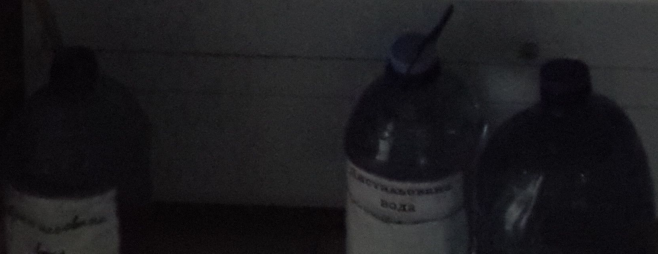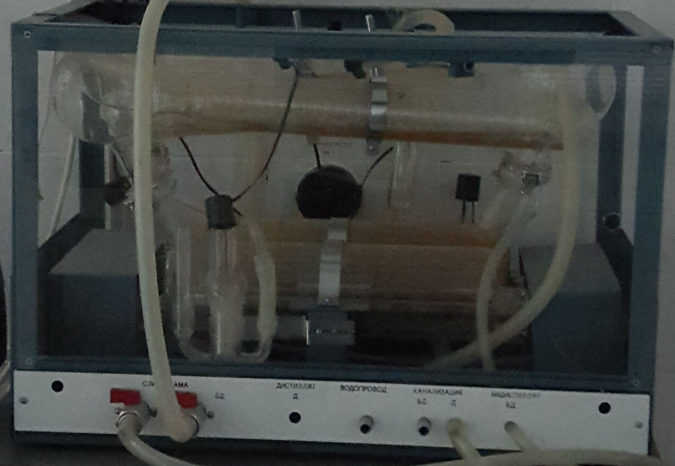

НЕ КИД
холодил
агрег

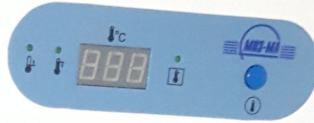

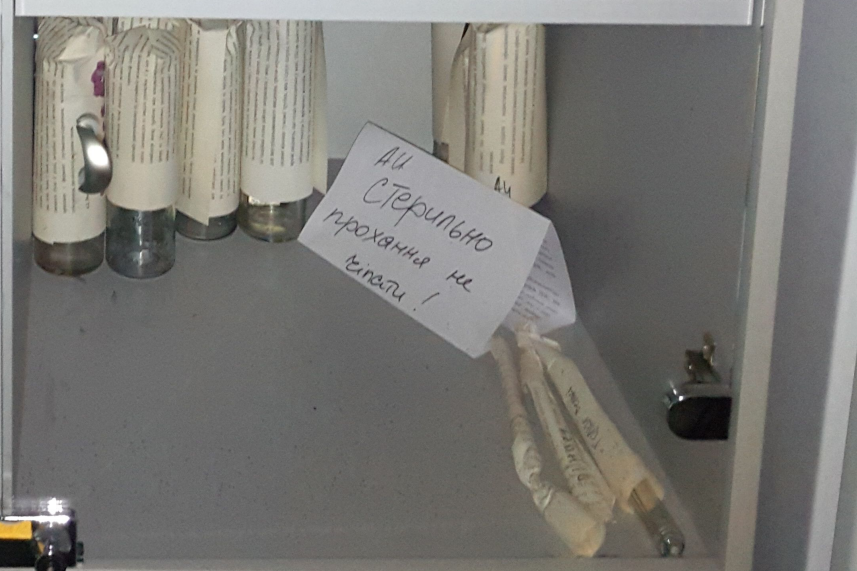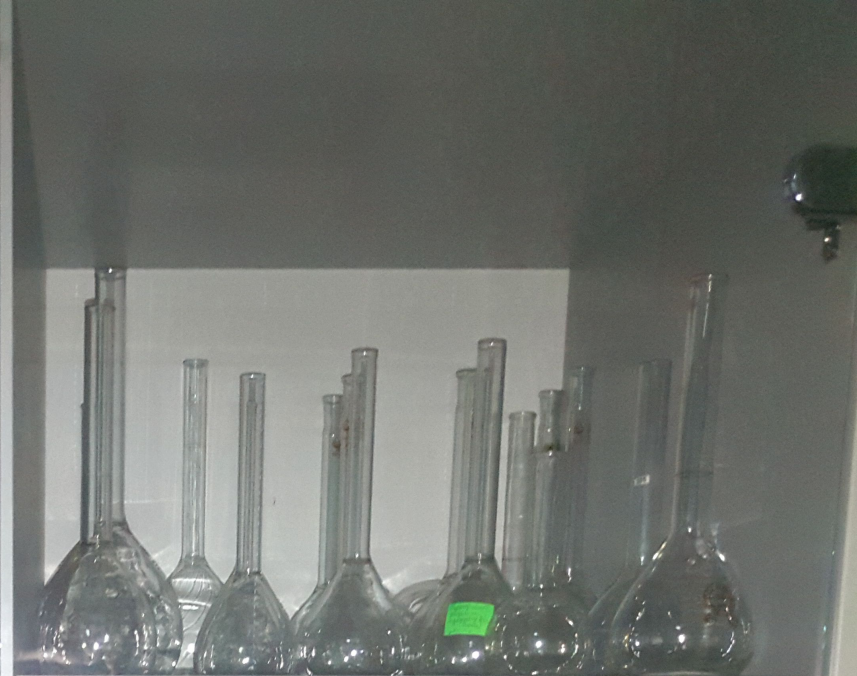

Ал
Стерильно
прохання не
впади!




ЮС00019 АА





АИ
стерильно
прохання не
тпелі!



Холодильник
для зразків





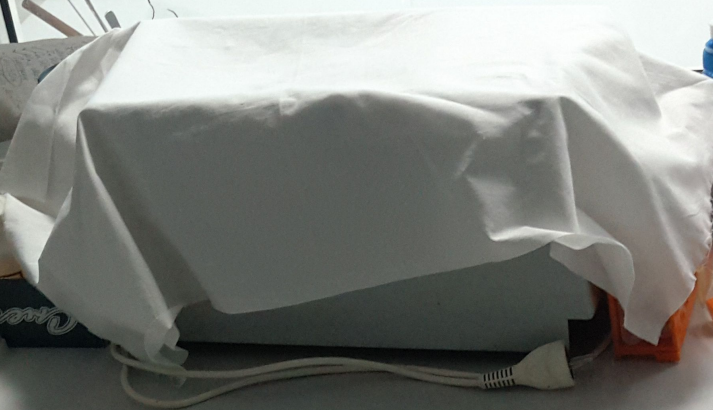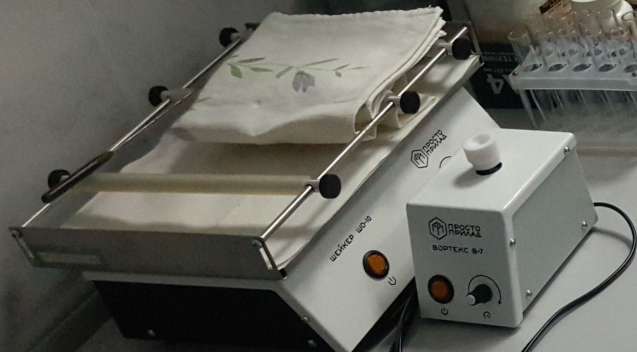

FARE NOVA
FARE NOVA



ПРОСТО
ПРИЛАД



ВОРТЕКС В-7






ШЕЙКЕР ШО-10

ПРОСТО ПРИЛАД

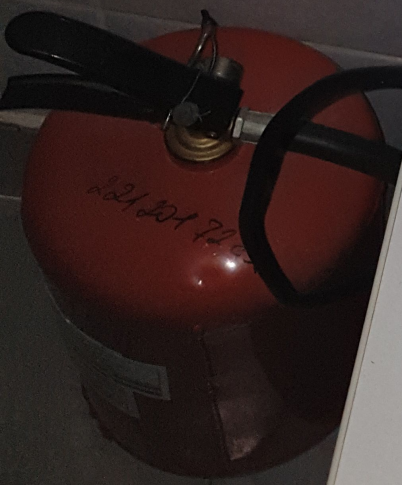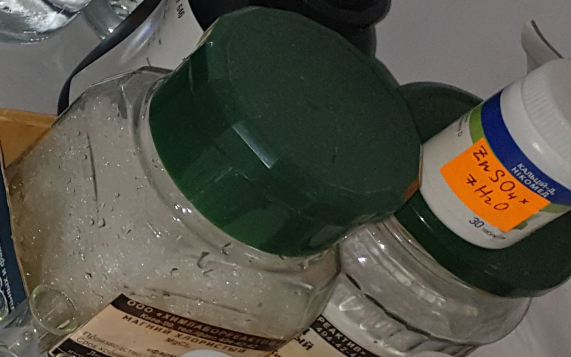






1401

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ





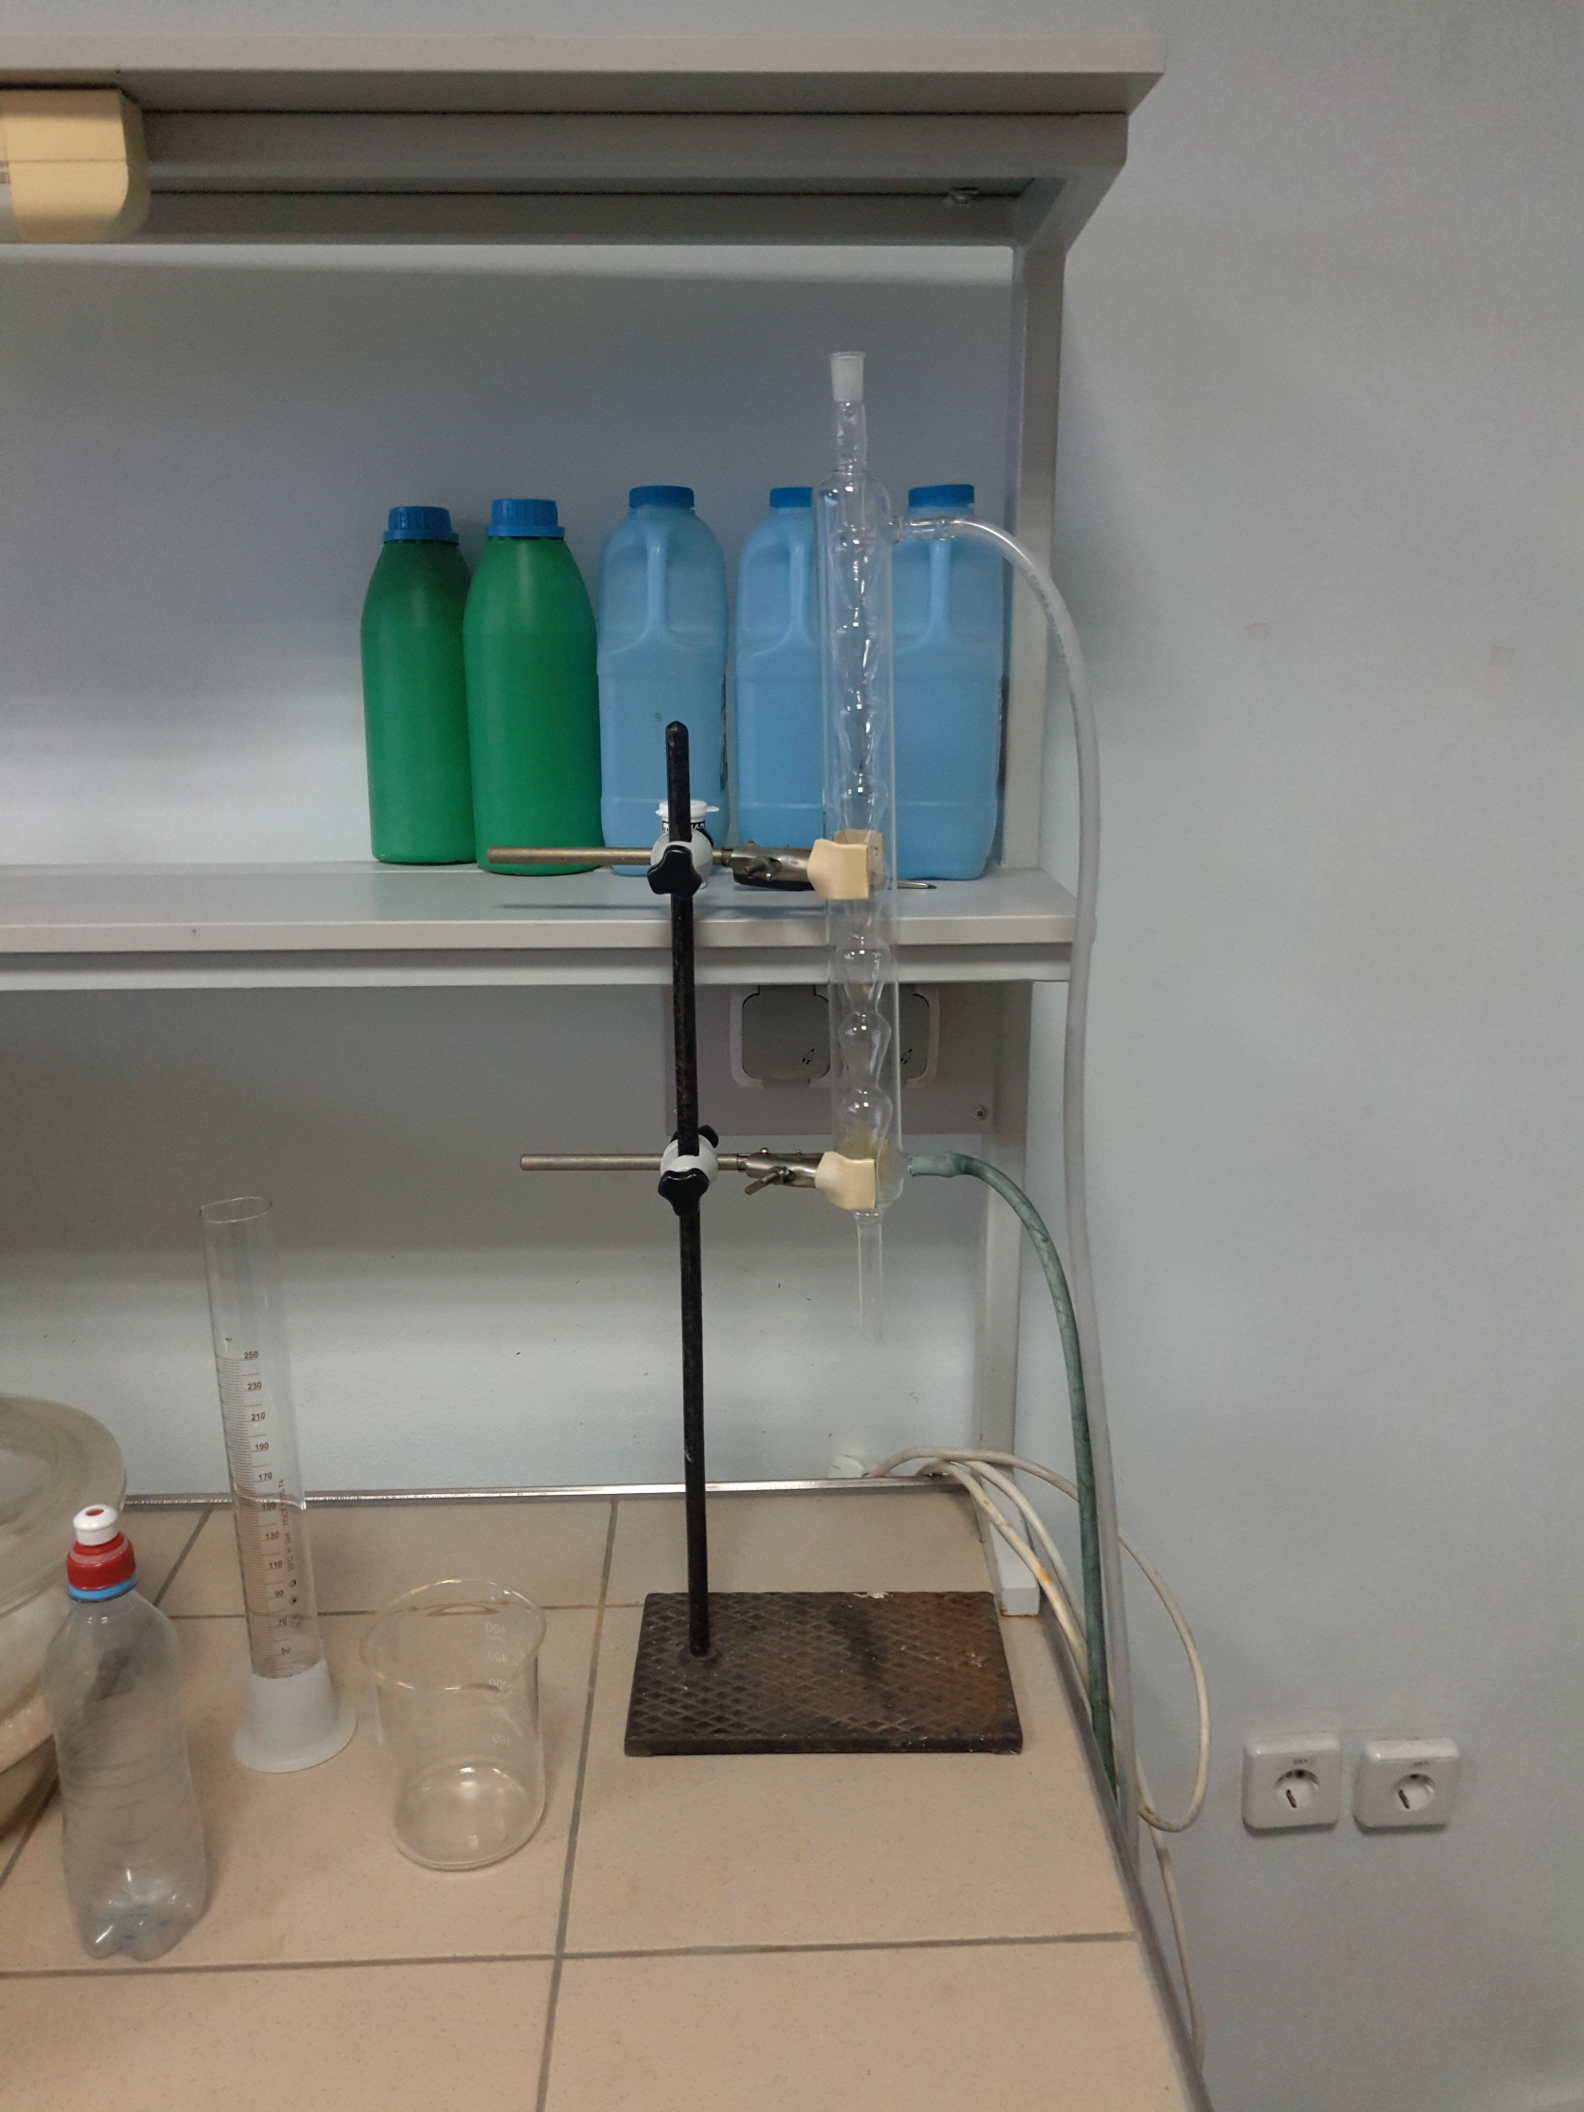



ФОТОМЕТР
КФК-3-01-«30М3»

000 "СЭП"
РЕЗУЛЬТАТ
Програм. лимит
04:50


1	2	3	A
4	5	6	B
7	8	9	C
*	0	#	D



ФОТОМЕТР
КФК-3-01-«30M3»

000 «30M3»
РЕЗУЛЬТАТ
Программа прибора
04.4.

1	2	3	A
4	5	6	B
7	8	9	C
*	0	←	D

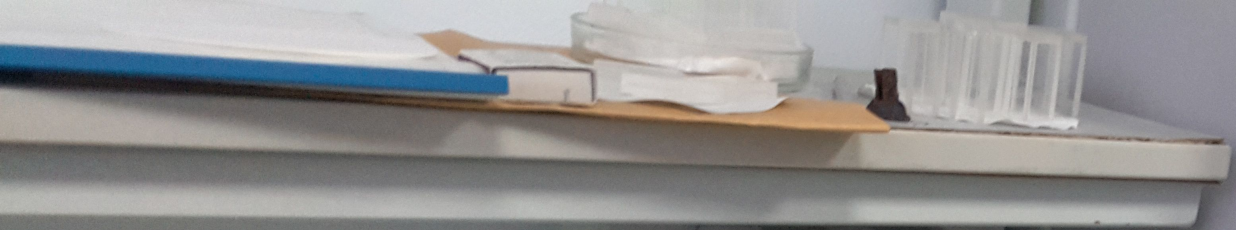





КХ-2
КОНЦЕНТРАТОМЕР

СИБЗКАПРИБОР

mg/dm³

КАВЕРОВА

КХ

ТРЕК

КОРПОС



СВ









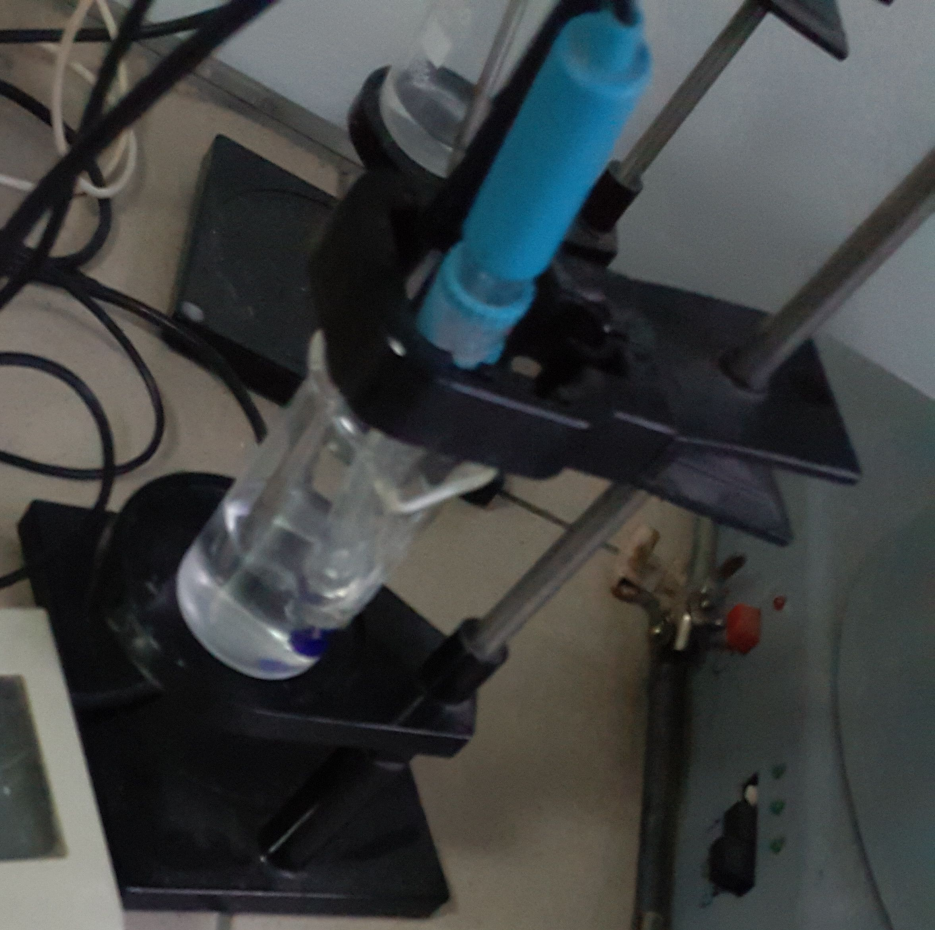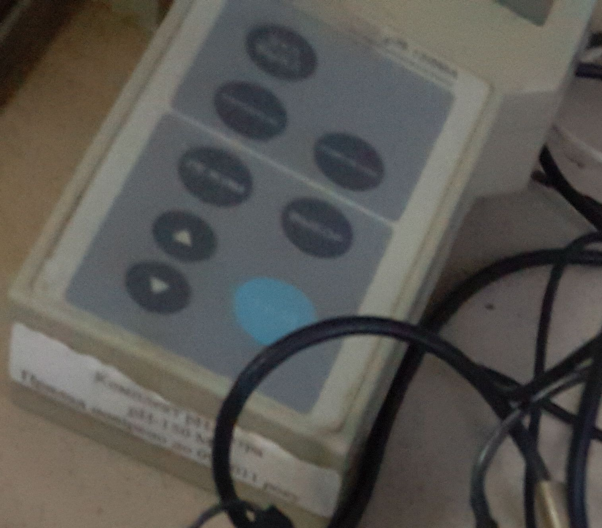







CY-5
N035
2005
0,05 °S


1000
1000

1000
1000





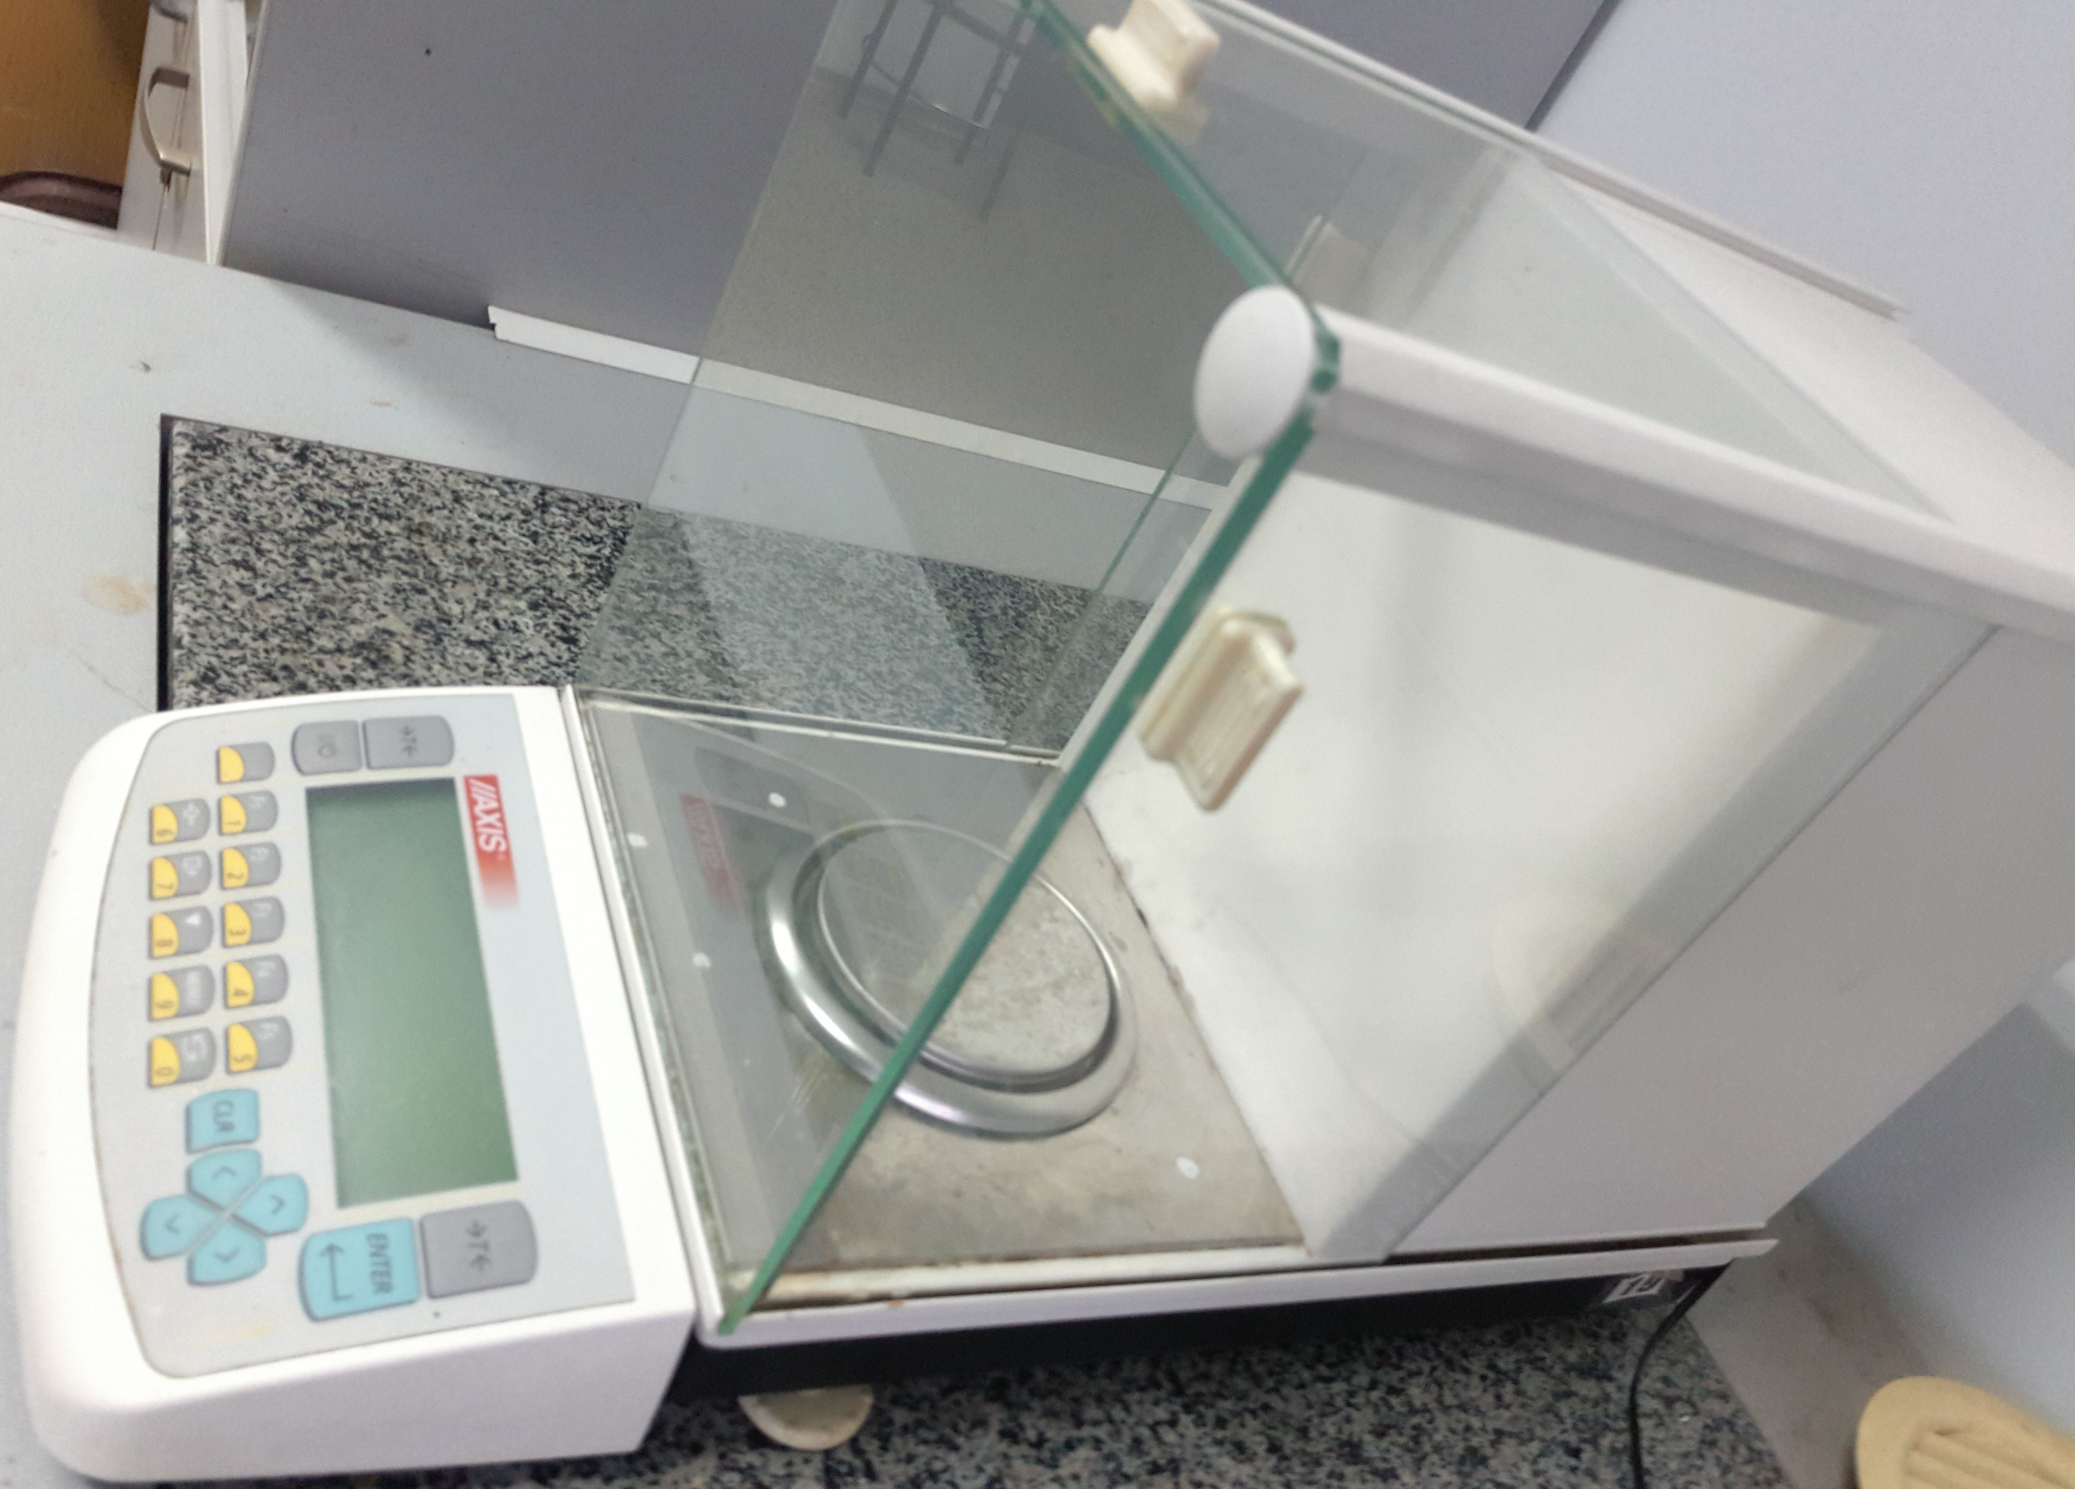

OHAUS

ENTER

CAL

ON

T<

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



100% KOH

100 1% pure CuSO₄

MSM

Ba(OH)₂

NaOH

NaOH

NaOH

Na₂CO₃

Na₂CO₃ 0.014 M

NaCl

SPEE

mond

MAESTRO standard



3% розчин KOH

5%

0,001% розчин CuSO_4

MSM

Ba OH_2

NaOH

NaOH 0,5%

Na_2F 2,7%

$\text{Na}_2\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_6$ 0,014 M

MSM

mondì business paper

MAESTRO standard



23

TermoLab HIGH TEMPERATURE FURNACE

ГАРАНТИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ
TermoPro
30 МЕСЯЦЕВ

SNOL

$Ba(OH)_2$
9,02 моль/л

$BaCl_2$
1/2

